

Kundennummer*	<input type="text"/>
Labor*	<input type="text"/>
Patienten-ID (kein Name)*	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
E-Mail*	<input type="text"/>

* muss ausgefüllt werden

Bitte eines von beiden ankreuzen:

Hiermit gebe ich mein Einverständnis zur umgehenden Anfertigung und Fertigstellung der Konstruktion.

Bitte senden Sie mir die Daten der Konstruktion zur Überprüfung per E-Mail zu.

Bitte beachten Sie die Anforderungen in unserer Arbeitsanleitung. Nach Ihrer Freigabe wird die Konstruktion umgehend gefertigt und es sind keine Änderungen ohne Mehrkosten mehr möglich.

A-Post

Expresssendung «Mond» (Zusätzliche Kosten): Am Abend aufgegeben, am Folgetag bis 9 Uhr zugestellt.

Expresssendung «Blitz» (Zusätzliche Kosten): Am Vormittag aufgegeben – bis 17 Uhr zugestellt (bei 180 Poststellen).

Ich bestätige hiermit, dass ich die Genauigkeit der Position der Implantatanaloge und der gelieferten Modelle überprüft habe. Ich bescheinige, dass die bei der Bestellung gemachten Angaben richtig sind und dass die zugesandten Teile, die mit der Mundhöhle

oder Körperflüssigkeiten in Berührung gekommen sind, desinfiziert worden sind. Diese Bestellung berechtigt Cendres+Métaux SA dazu, die übermittelten Informationen und Materialien zur Anfertigung einer Suprakonstruktion zu verwenden.

Laborstempel und Unterschrift


Fertigungszeiten

Produkte	Material	Fertigungszeiten
Abutments, Kappen, Teleskopkronen, Brücken auf natürlichen Zähnen, etc.	Pekkton®, Titan, Kobalt-Chrom	1– max. 2 Arbeitstage
Verschraubte Brücken, Wrap-Around, Stegversorgungen, Verstärkungsgerüste, etc.	Pekkton®, Edelmetall, Kobalt-Chrom, Titan	2– max. 3 Arbeitstage
Abutments, Kappen, Teleskopkronen, Brücken auf natürlichen Zähnen, etc.	Edelmetall	2– max. 3 Arbeitstage

* Die Fertigungszeiten bezeichnen den Zeitraum von der Freigabe des Designs (vor 12:00 Uhr) bis zum Versand des Produktes (16:00 Uhr) an den Kunden. Dabei beziehen wir uns auf Arbeitstage; Wochenenden und Feiertage sind nicht berücksichtigt.

Fall Beschreibung





Bitte benutzen Sie die folgende Abkürzungen um Ihren Fall zu beschreiben.

Implantatposition:
 Extension: X E (z.B. E3 bedeutet
 Extension von 3mm)
 Dalbo® D
 Locator® L
 Stegverbindung: 

Material:

- Chrom-Kobalt (CoCr)
- Titan (Ti)



Steg-Typ:

- | | | | |
|--|---|--|---|
| Dolder® Makro | | Dolder® Mikro | |
| <input type="checkbox"/> Geschiebe  | <input type="checkbox"/> Gelenk  | <input type="checkbox"/> Geschiebe  | <input type="checkbox"/> Gelenk  |
| <input type="checkbox"/> Anderer Steg-Typ | | | |
| <input style="width: 100%;" type="text"/> | | | |

Zahn Nr.	Implantat Hersteller	Implantat Typ

Zusätzliche Optionen

- Bestellung Dalbo® Patrizie: Stk.
- Bestellung CM LOC® Patrizie: Stk.
- Bestellung Dalbo® Matrize:
- | | | | | |
|------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|
| Classic basic | <input type="text"/> Stk. | PLUS basic | <input type="text"/> Stk. | |
| Classic elliptic | <input type="text"/> Stk. | PLUS elliptic | <input type="text"/> Stk. | B <input type="text"/> Stk. |
- Bestellung M-SG® Star 1 Matrize:
- Titan Stk. Yelor Stk.
- Bestellung Dolder® Matrize:
- | | | | | |
|--------------------|---------|---------------------------|-------|---------------------------|
| Standard | Elitor® | <input type="text"/> Stk. | Titan | <input type="text"/> Stk. |
| Asymmetrisch (L30) | Elitor® | <input type="text"/> Stk. | Titan | <input type="text"/> Stk. |
- Länge: 25mm 50mm

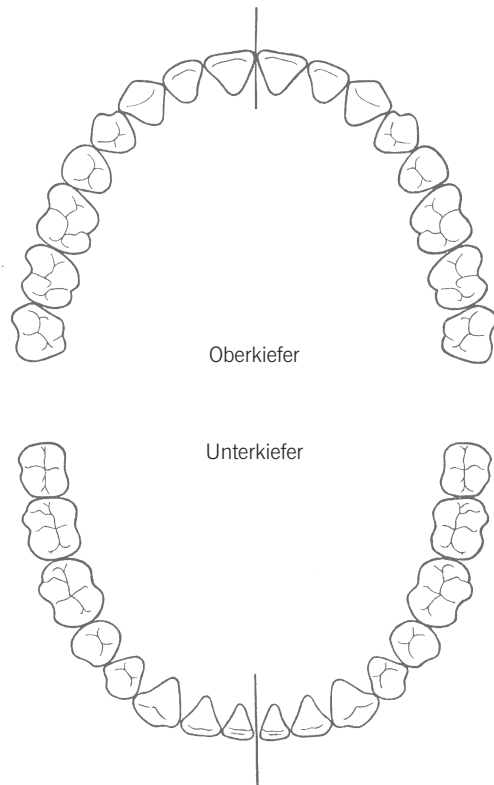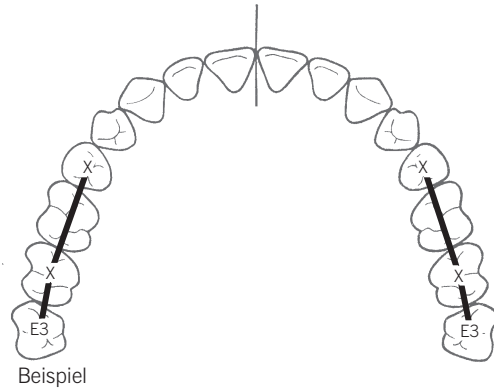

CM Connect Schrauben

- Ja Nein
- Schrauben nur bei ausgewählten Implantatsystemen mitgeliefert – siehe Implantatliste/CM Connect Katalog.

Liste mit den gesendeten Komponenten

- Gipsmodell
- Gegenbiss Modell
- Wax-up / Situ Modell
- Artikulator
- Zahnfleischmaske
- Biss Registration

Weiteres